

先生各位

C型肝炎ウイルス検診

HCV抗体（検診）内容変更のお知らせ

＜測定法と結果解釈について＞

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご愛顧を賜り有難く厚く御礼申し上げます。
 このたび下記の検査項目につきまして、検査内容の変更をさせて頂きたくご案内申し上げます。
 先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくご了承の程、お願い申し上げます。
 尚、検査内容の変更に伴い、HCV抗体（検診）のフロー図が裏面のように変更になりましたのでご利用いただきたく存じます。

謹白

記


●変更実施日 2010年4月1日（木）

●変更内容

項目コード	項目名称	変更箇所	新	現行
4612 検査案内 未掲載	HCV抗体（検診）	試薬名	ルミパルスⅡ オートHCV, 富士レビオ株式会社	アキシムHCVダイナパックⅡ, アボットジャパン株式会社
		検査方法	C L E I A	E I A
		基準値	陰性 (C.O.I. 1.0未満)	陰性 (S/C0 1.0未満)
		結果表示	カットオフインデックス (cut off index:C.O.I.)	S/C0 (S:検体の蛍光強度の 変化率, C0:カットオフ値)
		判定基準	<低力価> 1.0以上 5.0未満 <中力価> 5.0以上 50.0未満 <高力価> 50.0以上	<低力価> 1.0以上 15.0未満 <中力価> 15.0以上 100.0未満 <高力価> 100.0以上

HCV検診のフローチャート

「ルミパルスHCV抗体検査」と「HCV抗原検査」「HCV-RNA検査」の効果的な組み合わせ

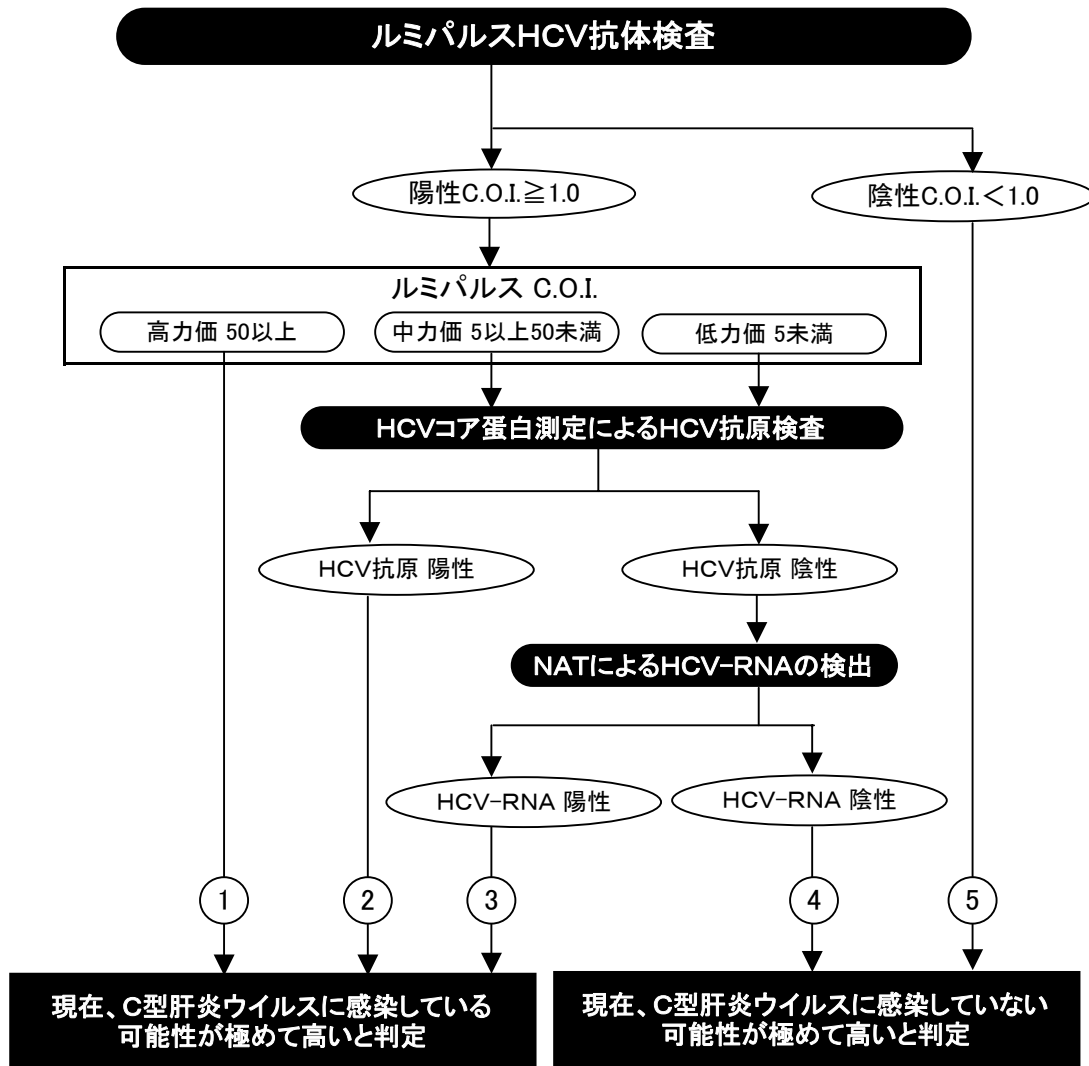

厚生労働省老健局肝炎ウイルス検査についての実施要項より

2010年4月1日より実施